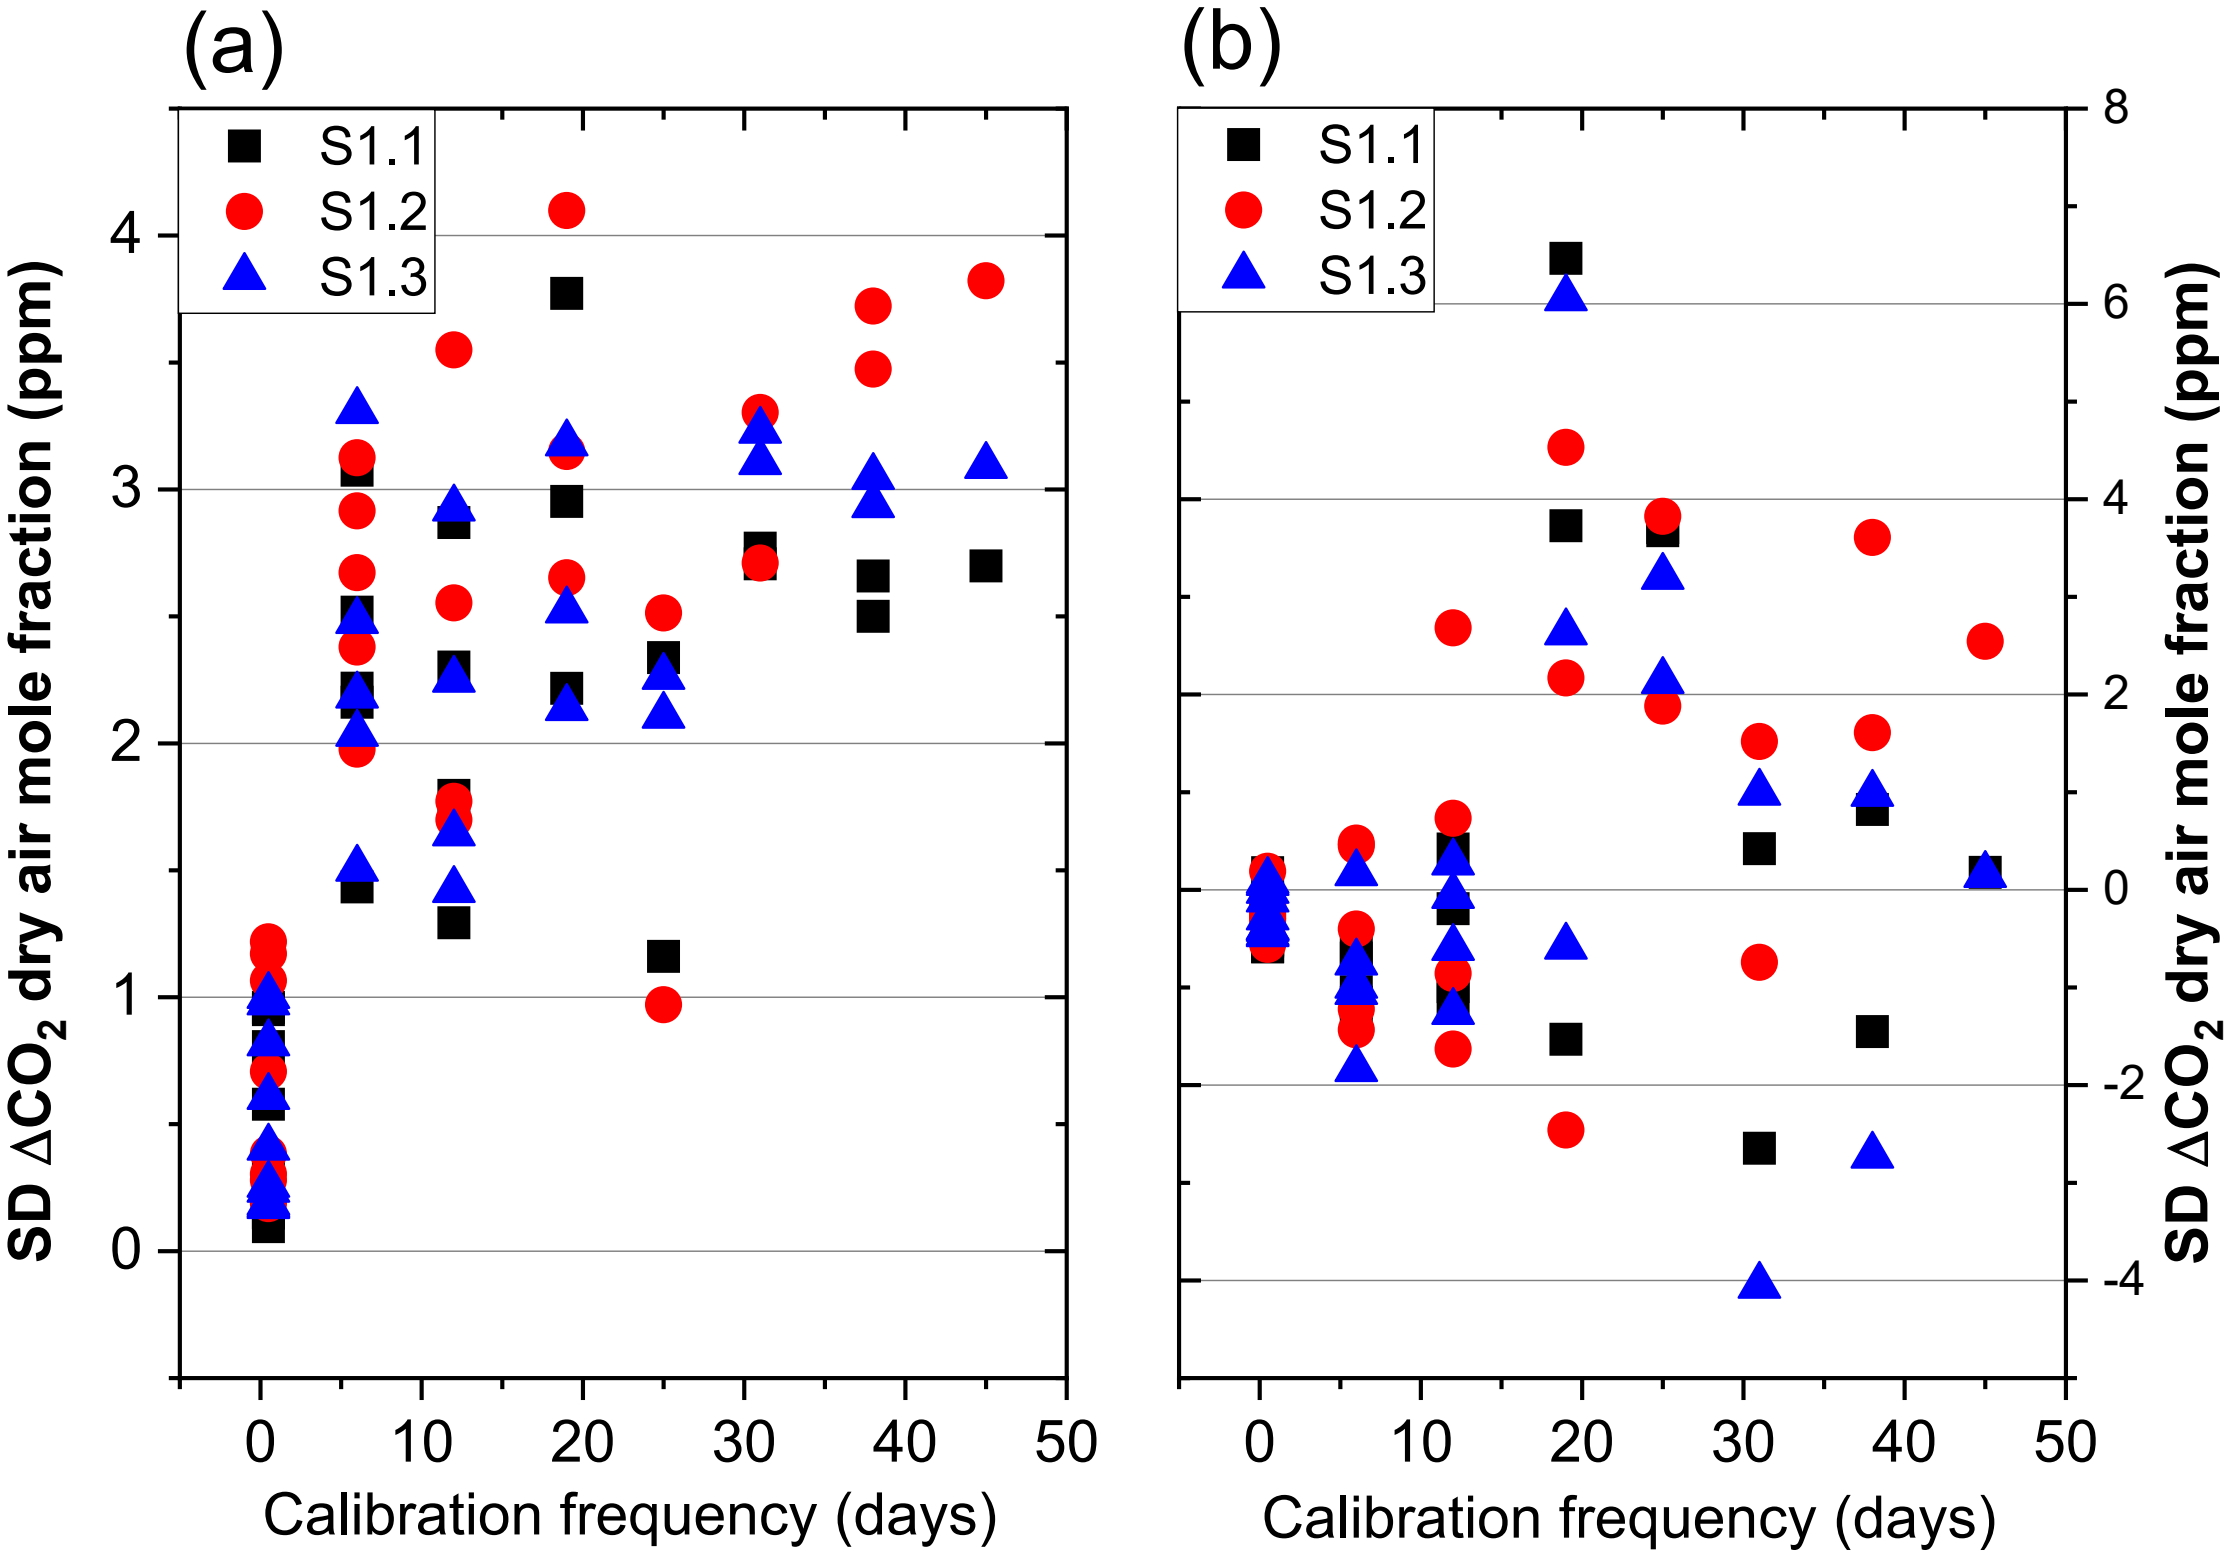
(a)
(b)
S1.1
S1.2
S1.3
SD ΔCO2 dry air mole fraction (ppm)
Calibration frequency (days)
0
10
20
30
40
50
-4
-2
0
2
4
6
8